erbe
power your performance.

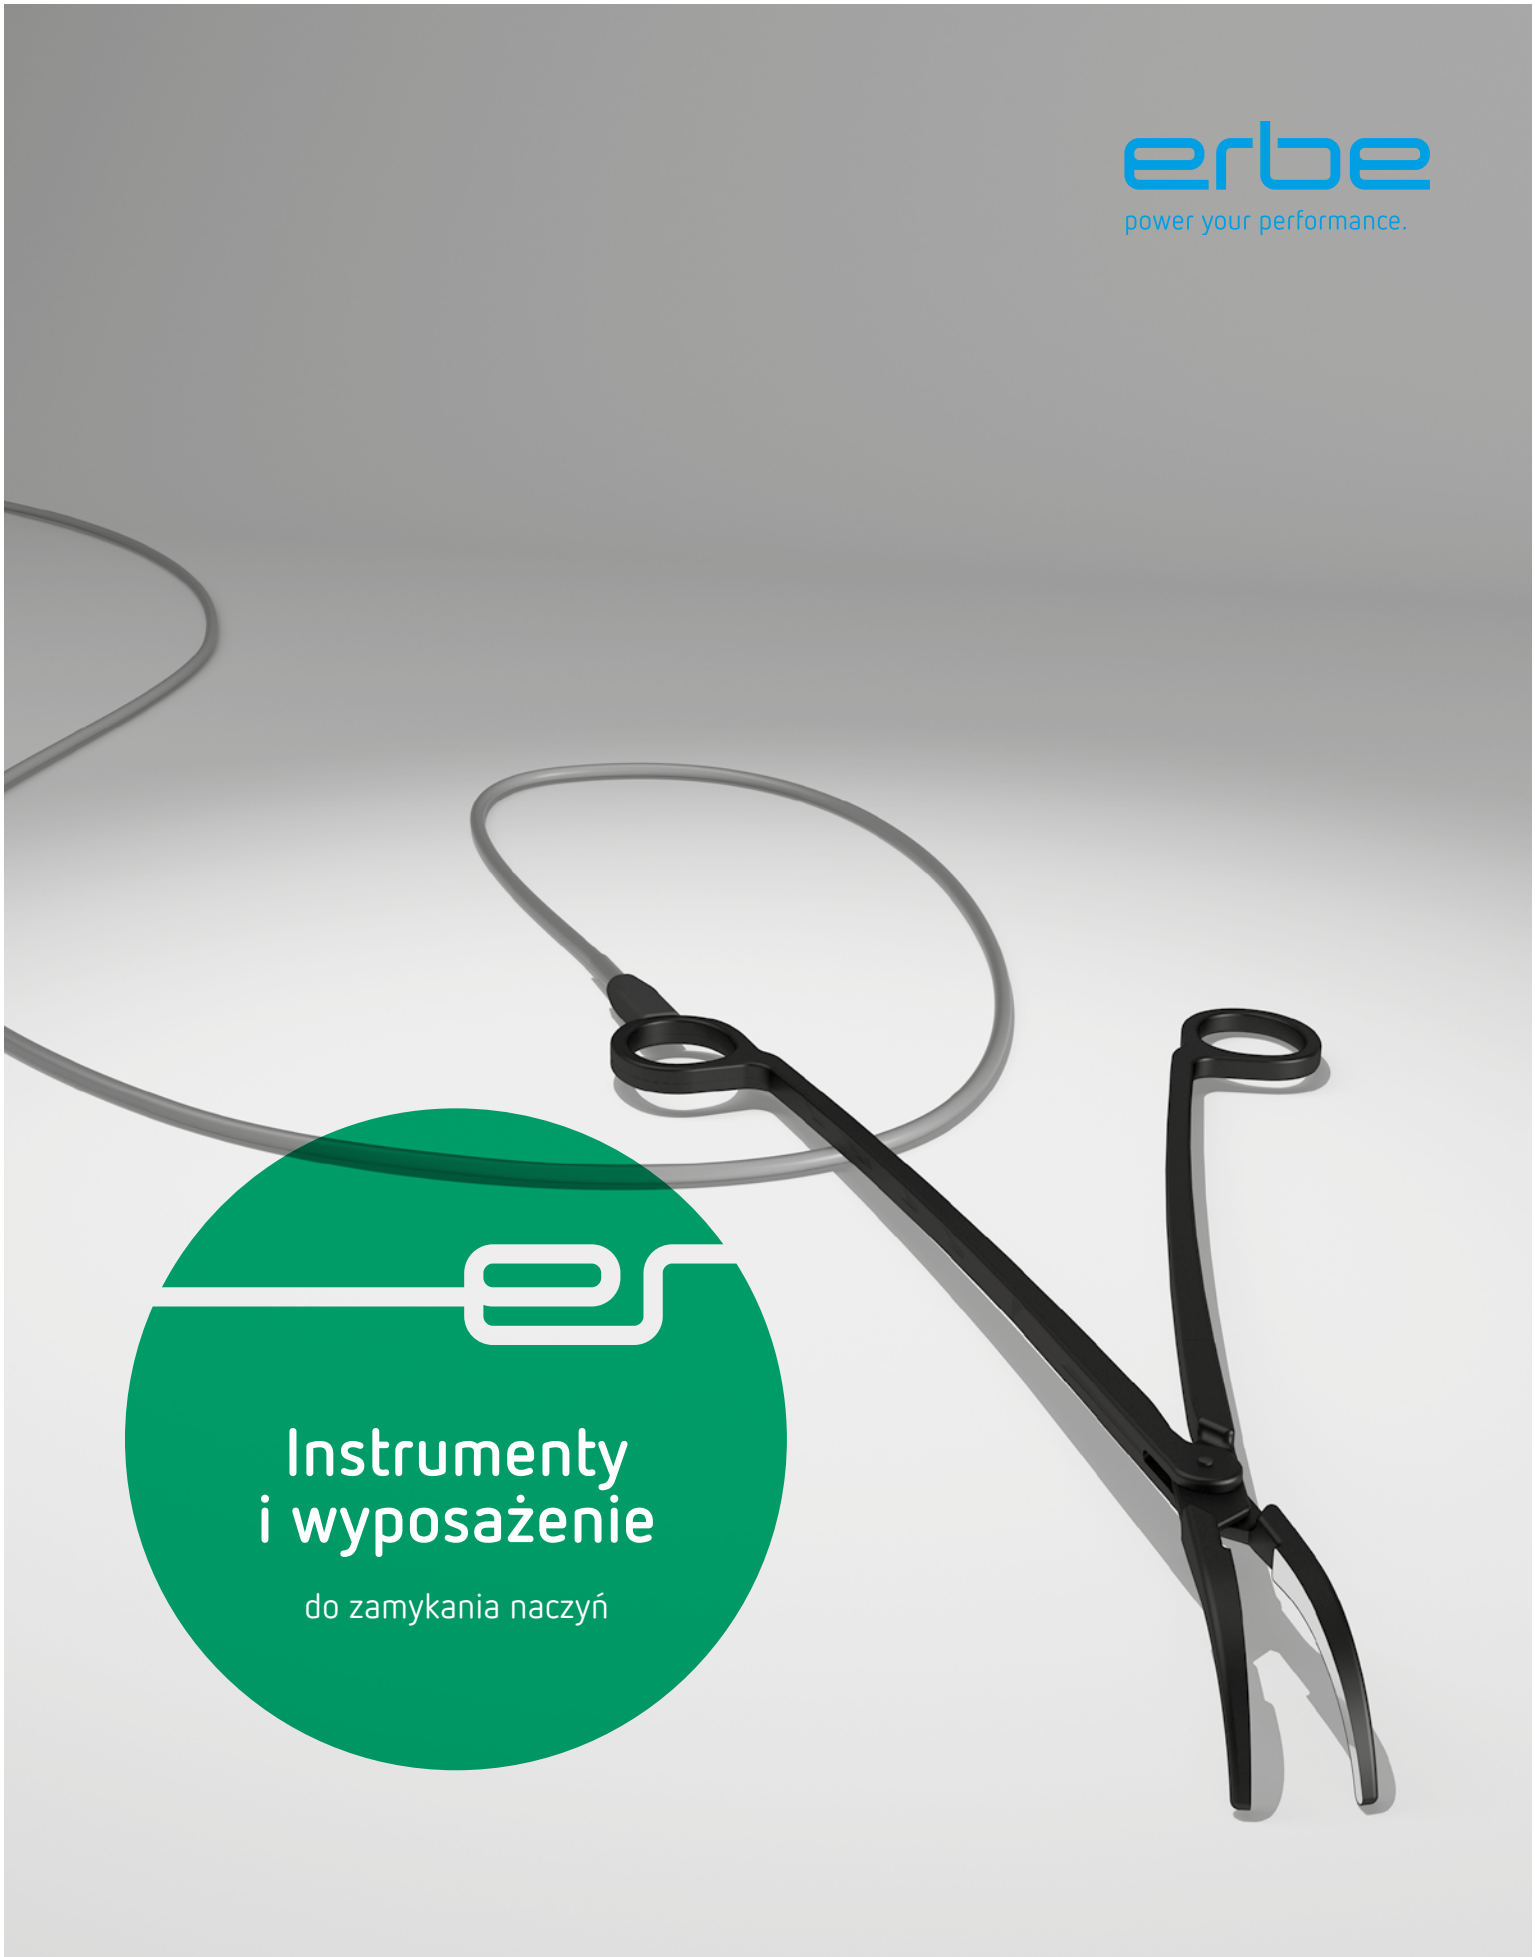

Instrumenty i wyposażenie

do zamykania naczyń

Ważne wskazówki

Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowywuje katalogi swoich produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.

Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych, ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.

Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych. Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Pozostałe informacje dotyczące produktu

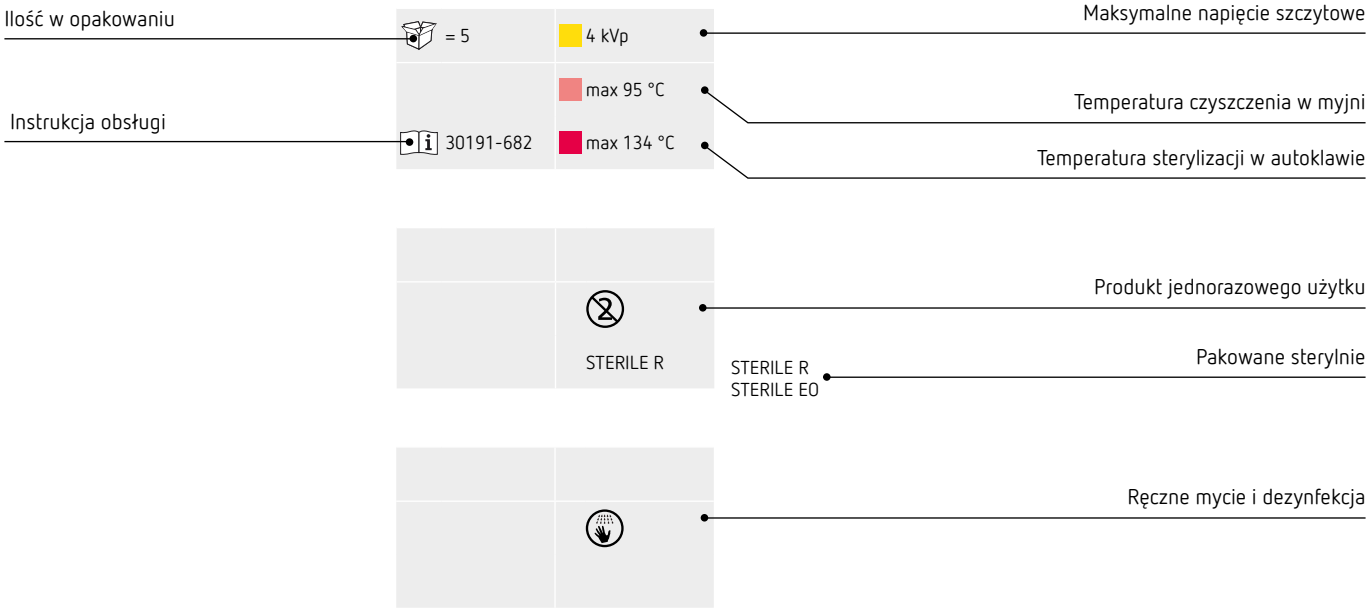

Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Spis treści

Zamykanie naczyń

Instrumenty i wyposażenie

04 TriSect rapide
04 BiClamp knife
05 BiClamp
13 Kleszczyki laparoskopowe BiClamp
17 Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E
19 Akcesoria do mycia i dezynfekcji na kleszczyki laparoskopowe BiClamp i BiClamp E

TriSect rapide

TriSect rapide 140, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 140 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2





No. 21195-400	
= 5	0.22 kVp
31195-056	STERILE EO

TriSect rapide 200, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 200 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2





No. 21195-401	
= 5	0.22 kVp
31195-056	STERILE EO

TriSect rapide 350, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 350 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2





No. 21195-402	
= 5	0.22 kVp
31195-056	STERILE EO

TriSect rapide 450, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 450 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-403	
= 5	0.22 kVp
31195-056	STERILE EO

BiClamp knife

BiClamp knife 220, jednorazowy, zakrzywiony 36 mm, długość 220 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2





No. 20195-315	
= 5	0.25 kVp
30195-400	STERILE EO

BiClamp



150 mm

200 mm

BiClamp



BiClamp



100 %

270 mm

280 mm

BiClamp

BiClamp



No.	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

Typ instrumentu	Długość	Kształt	Okładki	Nr kat.
BiClamp 150 C 	150 mm	zakrzywiony 23°	gładkie (z dystansami)	20195-221 21195-221
BiClamp 190 C 	190 mm	zakrzywiony 23°	gładkie (z dystansami)	21195-190
BiClamp 201 T 	200 mm	zakrzywiony 18°	gładkie (z dystansami)	20195-202 21195-202
BiClamp 210 	210 mm	zakrzywiony 25°	ze żłobieniem	20195-200 21195-200
BiClamp 271 T 	270 mm	zakrzywiony 18°	gładkie (z dystansami)	20195-203 21195-203
BiClamp 280 	280 mm	zakrzywiony 25°	gładkie (z dystansami)	20195-280 21195-280

100 %

BiClamp

BiClamp 150, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, z powłoką ceramiczną,
np. do tyroidektomii





No. 20195-221	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 201 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, w zabiegach chirurgii otwartej,
np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej





No. 20195-202	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 210, zakrzywiony 25°, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, okładki ze żłobieniem,
np. do histerektomii waginalnej





No. 20195-200	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp

BiClamp 271 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
w zabiegach chirurgii otwartej, np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej



	No. 20195-203
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 280, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 280 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF,
w zabiegach chirurgii otwartej, np. cystektomii lub prostatektomii



	No. 20195-280
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp

BiClamp 150, MF-2, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, z powłoką ceramiczną, np. do tyroidektomii





No. 21195-221	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 190, MF-2, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 190 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, z powłoką ceramiczną, np. do tyroidektomii





No. 21195-190	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 201 T, MF-2, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, np. do zabiegów chirurgii otwartej, np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej





No. 21195-202	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 210, MF-2, zakrzywiony 25°, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, okładki ze żłobieniem, np. do histerektomii waginalnej





No. 21195-200	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp

BiClamp 271 T, MF-2, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2,
np. do zabiegów chirurgii otwartej, np. operacjach jelit,
żołądka lub histerektomii brzusznej





	No. 21195-203
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

BiClamp 280, MF-2, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 280 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2,
np. do zabiegó chirurgii otwartej, np. cystektomii lub prostatektomii





	No. 21195-280
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
31195-003	max 138 °C

Adaptery	Sztuk	Nr kat.
Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2 do VIO 300 D 	1	20183-100
Adapter, gniazdo MF-2 / MF-U, wtyczka MF do VIO 3 oraz VIO 300 D 	1	20183-101

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument



No. 20195-134	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument



No. 20195-135	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument



No. 20195-136	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument



No. 20195-137	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp

Kleszczyków laparoskopowych BiClamp, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF



No. 20195-228	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

BiClamp 110, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 110 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument, np. do operacji minimalno inwzayjnej tyroidektomi (MIVAT)



No. 20195-230	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-096	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument



No. 21195-134	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument



No. 21195-135	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument



No. 21195-136	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument



No. 21195-137	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyków laparoskopowych BiClamp, typ Kelly, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument



No. 21195-228	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp

BiClamp 110, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 110 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompletny instrument, np. do operacji minimalno inwzayjnej tyroidektomi (MIVAT)





No. 21195-230	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Pojedyncze komponenty kleszczyków	Sztuk	Nr kat.
Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-228)	1	20195-236
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-134)	1	20195-146
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-135)	1	20195-147
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-136)	1	20195-148
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-137)	1	20195-149
Wkład do BiClamp 110, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 110 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-230)	1	20195-232
Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych i kleszczyków BiClamp LAP	1	20195-141
Płaszcz do kleszczyki BiClamp 110, ø 5 mm, długość 110 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-230)	1	20195-234
Uchwyt do kleszczyków BiClamp i kleszczyki BiClamp 110, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF	1	20195-145
Uchwyt do kleszczyków BiClamp i kleszczyki BiClamp 110, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2	1	21195-145

Adaptery	Sztuk	Nr kat.
Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2 do VIO 300 D	1	20183-100
Adapter, gniazdo MF-2/MF-U, wtyczka MF do VIO 3 oraz VIO 300 D	1	20183-101

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF



No. 20195-246	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF



No. 20195-247	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF



No. 20195-248	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-096	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF



No. 20195-249	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-096	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF



No. 20195-229	
	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-246	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-247	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-248	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, MF-2, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-249	
= 1	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyków laparoskopowych BiClamp E, typ Kelly, MF-2, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-229	
	0.25 kVp
	max 95 °C
30195-119	max 138 °C

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E

Pojedyncze komponenty kleszczyków		Sztuk	Nr kat.
Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-229, 21195-229)		1	20195-236
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-246, 21195-246)		1	20195-146
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, typ Maryland, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-247, 21195-247)		1	20195-147
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-248, 21195-248)		1	20195-148
Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp E, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (do instrumentu o nr kat. 20195-249, 21195-249)		1	20195-149
Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E, ø 5 mm, długość 340 mm		1	20195-241
Uchwyt do kleszczyków laparoskopowe BiClamp E, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF (per 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)		1	20195-240
Uchwyt do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2 (do 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)		1	21195-240

Adaptery		Sztuk	Nr kat.
Adapter, gniazdo MF, wtyczka MF-2 do VIO 300 D		1	20183-100
Adapter, gniazdo MF-2/MF-U, wtyczka MF do VIO 3 oraz VIO 300 D		1	20183-101

Akcesoria do mycia i dezynfekcji na kleszczyki laparoskopowe BiClamp i BiClamp E

Akcesoria do mycia i dezynfekcji		Sztuk	Nr kat.
Szczoteczka do mycia maks. ø 3,5 mm, długość 650 mm, do ręcznego mycia i dezynfekcji		1	20191-279
Dren do płukania długość 500 mm, ze złączem typu Luer, do instrumentów laparoskopowych (LAP) do maszynowego mycia i dezynfekcji		1	20195-201

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa, Polska

Tel +48 22 642-25-26
sales.pl@erbegroup.com
erbegroup.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 2026-10 85100-968 non-US only